


Kohärenzspektren Somavedic Medic
Vergleich zwischen Probe und Referenz bei (-) Zirkularpolarisation

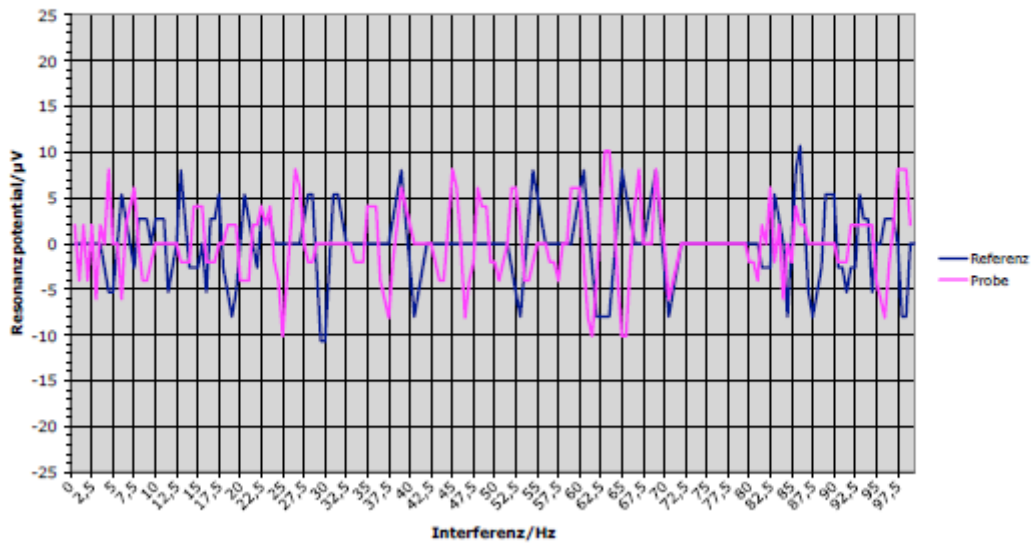

Koherenční spektra přístroje Somavedic Medic

Srovnání testu a reference při (-) cirkulární polarizaci

Rezonanční potenciál/ µT

Referenční hodnota

Test

R

Interference/Hz